

業務用 環境除菌洗剤

LION

メディプロ ジアフォーム クリーナー1000

施設内の汚染対策に
環境表面をしっかりと洗浄・除菌



商品特長


- 1 細菌とウイルスを除去*します。
- 2 汚染された環境表面に希釈不要で二次汚染対策が簡単にできます。
- 3 次亜塩素酸ナトリウムの泡が密着し、落としにくい血液汚れにも、高い洗浄力を発揮します。

*すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

医療
介護施設用

希釈不要ですぐに使える


廊下などの手すり・ドアノブ




トイレの手すりや便座



ベッドの柵やテーブル



嘔吐物や血液の付着した床



ライオンハイジーン株式会社



ジアフォームクリーナー1000

医療
介護施設用




520mL

洗浄性能


血液洗浄力

汚 垢：ヒツジ血液をPP板に滴下し、乾燥したものをモデル汚垢板とした
洗浄方法：汚垢板に各洗剤をスプレーまたは滴下し、一分間接触後、静かに水ですすいだ

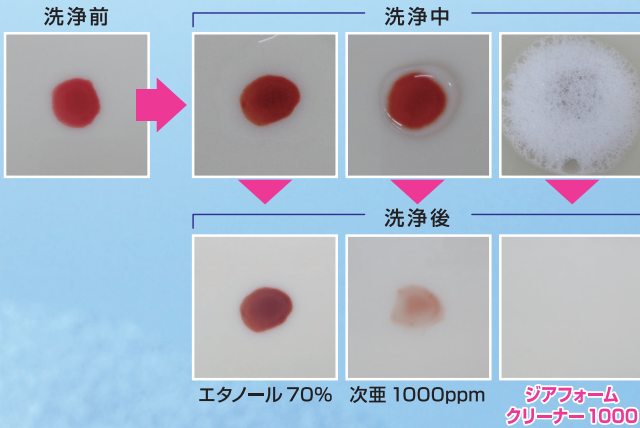

皮脂洗浄力

汚 垢：モデル皮脂汚垢をステンレス板に滴下し、乾燥したものをモデル汚垢板とした
洗浄方法：汚垢板に各洗剤をスプレーまたは滴下し、一分間接触後、静かに水ですすぎ残留した汚れを色素で染色した

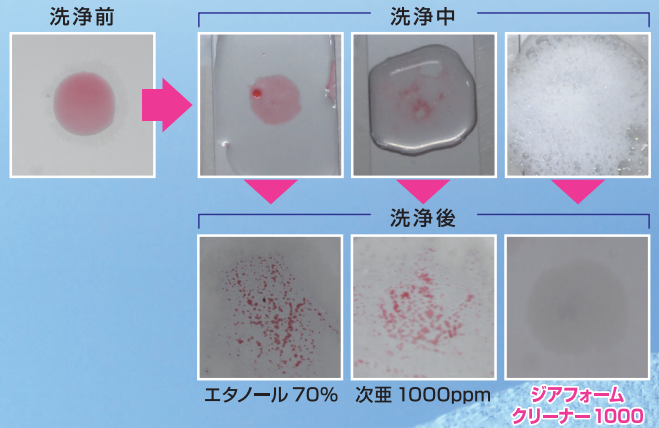

●除菌試験*

	添加菌液の 生菌数(/mL)	接触時間		
		15 秒	30 秒	60 秒
グラム陰性桿菌	3.6×10^7	<10	<10	<10
グラム陽性球菌	1.7×10^7	<10	<10	<10

<10 : 菌の生育を認めず (検出限界以下)
試験機関: (一財) 日本食品分析センター

使用 場 面: 廊下などの手すり、トイレの手すりや便座、ドアノブ
ベッドの柵やテーブル、嘔吐物や血液の付着した床など

使えないもの: ●パソコンなどの電子機器 ●モニター
●メラミン樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂
●ステンレス以外の金属 ●水がしみこむ白木・家具・壁・床など
●皮革製品 ●ワックス処理をした床 ●ニス塗り、ペイントの部分

●ウイルス除去試験*

	初期ウイルス数 (TCID ₅₀ /mL)	接触時間		
		15 秒	30 秒	60 秒
ウイルス	2.5×10^5	<6.3	<6.3	<6.3

検出限界値: 6.3TCID₅₀/mL

試験 機 関: (一財) 北里環境科学センター

*すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

使 用 方: ①ストッパーを最後まで上げて、天面の表示を「泡」にあわせる(顔に向けない)。
②約10cm離して対象物に直接スプレーする、もしくは、布などにスプレーして拭き取る。スプレーする時は、毎回レバーをひききる。スプレー時に、目に飛沫が入らないよう注意する。
③スプレーして拭き取った後、必ず洗剤がなくなるまでしっかり拭き取るか、流水で洗い流す。
④使用後はストッパーを最後まで下げて、天面の表示を「閉」にあわせる。

■梱内容

品 名	容 量	梱入数	寸法(mm)		重量(kg)		個 装 材 質	JANコード
			個 装	外 装	個 装	外 装		
メディプロ ジアフォームクリーナー1000	520mL	8本	幅 106 高さ 207 奥行 80	幅 326 高さ 223 奥行 218	0.6	5.2	スプレー: PP, PE ラベル: PS ボトル: PE	4903301239420

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本 社 : 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

TEL 03(6739)9050 (大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2023年4月現在のものです。
一部商品仕様等に変更がある場合がございますが、ご了承ください。
無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。